RADWAG BALANCES AND SCALES
ADVANCED WEIGHING TECHNOLOGIES

Tökéletes pontosság Rövid kijelzés-stabilizálási idő Négy mérési profil



Meghatározott mérési profilok

EGYEDÜLÁLLÓ MEGOLDÁS
LABORATÓRIUMI MÉRLEGEKHEZ

www.radwa

MEGHATÁROZOTT MÉRÉSI PROFILOK

A megoldás elérhető a 4Y, X2 és R laboratóriumi mérlegekhez

GYORS

A mérés rendkívül rövid idő alatt lezajlik, az eredmény stabilizálódása legfeljebb 2 másodpercet vesz igénybe

GYORS ADAGOLÁS


Rendkívül gyors reakció a tömegváltozásra

PRECÍZIÓ

A legjobb mérési ismételhetőségre összpontosít

Profilválasztás


A kezelő a négy rendelkezésre álló profil egyikének kiválasztásával testreszabhatja a mérleg paramétereit. A PRECISION profil a mérés ismételhetőségére összpontosít, és lehetővé teszi kis mennyiségű minta pontos lemérését. A FAST profil biztosítja a mérés gyorsaságát, és lehetővé teszi több minta tömegének rövid időn belüli meghatározását. A FAST DOSING profil növeli a mérleg érzékenységét, ennek köszönhetően a mérleg gyorsan reagál a tömegváltozásokra. Ez a funkció ajánlott a lemért minta

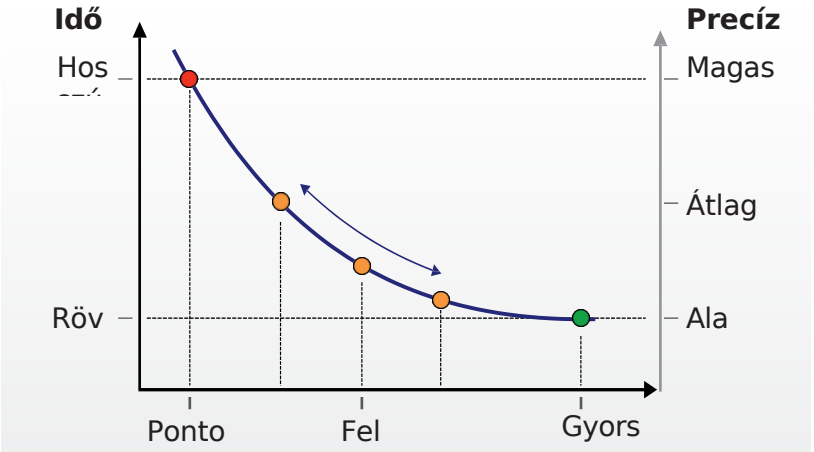

A mérési pontosság és a mérési idő közötti összefüggés.

A mérleg testreszabása

A USER profil lehetővé teszi a kezelő számára, hogy öt szűrőszint és három értékkiadási opció közül választva meghatározza a mérési időt. A szűrőt a mérés helyszínén uralkodó környezeti feltételek értékelése alapján kell kiválasztani. Kedvezőtlen körülmények között ajánlott egy nagyon lassú szűrőt választani, míg minél jobbak a környezeti feltételek, annál gyorsabb szűrőt lehet választani. A három értékkiadási opció egyikének kiválasztása a kiválasztott szűrőérték esetében csekély változást eredményez a teljes minta mérési idejében. A USER profil előnye, hogy minden kezelő számára egyénileg optimalizált mérési időt és mérlegpontosságot biztosít.

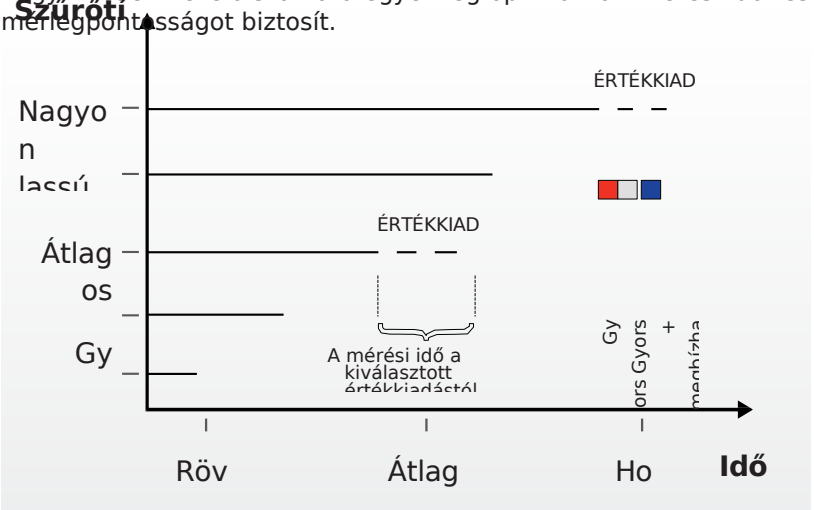

FELHAS ZNÁLÓ

Operátor által testreszabott profil

A szűrőtípus és a mérési idő közötti összefüggés.